



Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych

PYTANIE 1 : dot. części nr 3. Czy Zamawiający dopuści soczewką posiadającą współczynnik uwodnienia 25%, bez znacznika poprawności położenia, pozostałe parametry bez zmian?

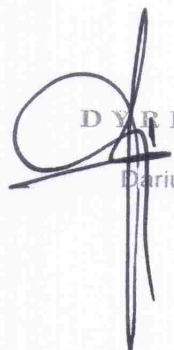
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 3 soczewek wewnątrzgałkowych bezaberracyjnych o parametrach określonych w zmienionym Załączniku nr 4.3 (uwzględniającym poprawę omyłki pisarskiej dokonanej niniejszym pismem).

PYTANIE 2 : Dotyczy części 3 – soczewki wewnątrzgałkowe bezaberracyjne. Czy zostanie dopuszczona soczewka tylnokomorowa, zwijalna, sterylna, sferyczna, dwuwypukła, hydrofilna, jednoczęściowa o angulacji 0 stopni, o ostrych krawędziach wzdłuż całej części optycznej i haptycznej z dodatkową barierą 360° na części optycznej soczewki. Soczewka o haptkach tworzących cztery stabilne punkty podparcia ze znacznikiem poprawności położenia, filtr UV; współczynnik uwodnienia nie mniej niż 26 %; zakres dioptrii +10D do +30D co 0,5 D; zakres dioptrii 0,0D do +9,0 D co 1,0 D; średnica części optycznej 6mm (+ - 0,25mm); długość całkowita 11mm (+ - 0,25mm). Do każdej soczewki zestaw implantacyjny jednorazowy (kartridż+ injektor).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 3 soczewek wewnątrzgałkowych bezaberracyjnych o parametrach określonych w zmienionym Załączniku nr 4.3 (uwzględniającym poprawę omyłki pisarskiej dokonanej niniejszym pismem).

Jednocześnie stosownie do art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a mianowicie w Załączniku nr 4.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprawia omyłkę pisarską wpisując w miejsce „sferyczna” zapis „asferyczna”.

W załączeniu zmieniony załącznik 4.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


D Y R E K T O R
Dariusz Jorg

FORMULARZ CENOWY
WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 – soczewki wewnątrzgałkowe bezaberracyjne

L.p	Przedmiot zamówienia	Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia (numer katalogowy) /producent	J.m.	Wymagana ilość	Cena jednost. netto	Wartość netto	podatek VAT %	Wartość brutto
1	Soczewka bezaberracyjna, tylnokomorowa , zwijalna , sterylna , asferyczna ,dwuwypukła hydrofilna, jednoczęściowa o angulacji 0 stopni, o ostrych krawędziach ,wzdłuż całej części optycznej i haptycznej z dodatkową barierą 360° na części optycznej soczewki. Soczewka o haptenach tworzących cztery stabilne punkty podparcia ze znacznikiem poprawności położenia, pochłaniające promieniowanie UV. współczynnik uwodnienia nie mniej niż 26 % . zakres dioptrii + 10D do +30D co 0,5 D zakres dioptrii 0,0D do +9,0 D co 1,0 D. średnica części optycznej 6mm (+ - 0,25mm) długość całkowita 11mm (+ - 0,25mm). Do każdej soczewki zestaw implantacyjny jednorazowy (kartridż+ injektor)		Szt.	600				

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy