


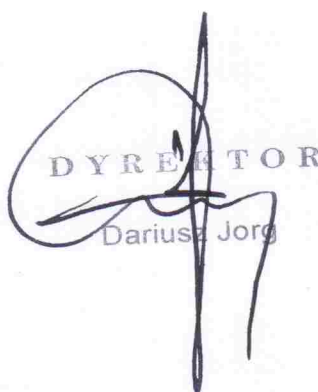

Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników wraz z najmem analizatorów

1. **Pytanie** - Czy zamawiający dopuści analizator wyposażony w jedną igłę dozującą?
Efekt kontaminacji jest wyeliminowany dzięki użyciu w czasie płukania i mycia specjalnego płynu do dezynfekcji pod nazwą CA Clean.
Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora wyposażonego w jedną igłę dozującą, uwzględniając powyższe wyjaśnienia.
2. **Pytanie** - Czy zamawiający dopuści analizator z możliwością oznaczenia próbki cito, jednakże o ewentualnym powtórzeniu próbki patologicznej decyduje operator?
Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora z możliwością oznaczenia próbki cito, jednakże o ewentualnym powtórzeniu próbki patologicznej będzie decydować operator.
3. **Pytanie** - Czy zamawiający dopuści analizator bez możliwości automatycznego rozcieńczenia próbki po przekroczeniu wartości referencyjnej?
Zaoferowany analizator charakteryzuje się bardzo szeroką liniowością dla poszczególnych metod, znacznie przekraczając zakres referencyjny dla danej metody, przez co otrzymujemy od razu gotowy wynik, niewymagający powtórnej analizy.
Odpowiedź - Uwzględniając powyższe wyjaśnienia Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania również analizatora bez możliwości automatycznego rozcieńczenia próbki po przekroczeniu wartości referencyjnej.
4. **Pytanie** - Czy zamawiający dopuści analizator wyposażony w oprogramowanie w języku angielskim?
Interfejs graficzny użytkownika - dotykowy panel LCD, jest bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze. Aplikacje odczynnikowe są w języku polskim.
Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora wyposażonego w oprogramowanie w języku angielskim, przy założeniu, że interfejs graficzny użytkownika - dotykowy panel LCD, jest bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze, a aplikacje odczynnikowe są w języku polskim.


DYREKTOR
Dariusz Jorg