

Katowice dn. 17.03.2017r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego : Dostawa obłożenia operacyjnych jednorazowego użytku D/ZP/381/7A/17

Pytanie nr1

Pakiet 11

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylnej osłony na mikroskop w rozmiarze 115x260cm, osłona dodatkowo wyposażona w cztery taśmy samoprzylepne o długości 81cm, przymocowane w odstępach następująco 36cm, 46 cm oraz 46cm od siebie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr2

Pakiet 11

Pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opakowania zbiorczego w formie podajnika?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr3

Pakiet 14

Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania prześcieradło wykonane z włókniyny polipropylenowej laminowany folią polietylenową?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr4

Pakiet 14

Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podkład chłonny z rdzeniem o dużej wydajności nasączony wyciągiem z zielonej herbaty, zapobiegającym przemieszczaniu się bakterii?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr5

Pakiet 14, pozycja 1– Czy Zamawiający dopuści prześcieradło na rolce wykonane z jednej warstwy bibuły i jednej warstwy folii?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr6

Pakiet 14, pozycja 2– Czy Zamawiający dopuści prześcieradło na rolce wykonane z jednej warstwy bibuły i jednej warstwy folii?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr7

Pakiet 14, pozycja 3– Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniyny polipropylenowej PP o gramaturze 28 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr8

(pakiet nr 16) Czy Zamawiający zamiast strzykawki 2,5ml dopuści strzykawkę 3ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawki 3 ml.

Pytanie nr9

(pakiet nr 16) Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 4 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia kryteriów oceny ofert dotyczących terminu dostawy.

Pytanie nr10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 , pozycja 1,2,3 ściereczek chłonnych poliestrowo-celulozowych o rozmiarze 30x35 cm i gramaturze min. 73 g/m2 zamiast wykonanych z włókniyny typu spunlace. Obie te włókniyny posiadają podobne właściwości chłonne

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyrobu.

Pytanie nr11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2, pozycja 1,2,3 taśmy włókninowej 10x50 cm, samoprzylepnej o gramaturze 60g/m2, zamiast wymaganej gramatury 68g/m2. Opisywana taśma włókninowa służy do umocowania drenów lub innych elementów w trakcie wykonywania zabiegów i nie stanowi elementu pola krytycznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyrobu.

Pytanie nr12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2, pozycja 1 wzmocnionej serwety bocznej wykonanej w całości z mocnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 105 g/m2 i odporność na przenikanie cieczy min. 999 cm H2O. Opisywana serweta stanowi budowę warstwową (dwie warstwy chłonne i nieprzemakalna folia PE) co stanowi doskonałą barierę dla cieczy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2, pozycja 1 zestawu bez dodatkowego zawinięcia w serwetę stanowiącą pierwsze, wewnętrzne owinięcie zestawu. Zawinięcie to nie jest konieczne ze względu na aseptykę i zabezpieczenie pola operacyjnego ponieważ jest już zastosowana serweta 150x190cm będąca jednocześnie zawinięciem zestawu i okryciem stolika instrumentariuszki. Nie mające istotnego zastosowania, dodatkowe zawinięcie, podniesie koszty nie tylko samego obłożenia, ale również koszty utylizacji odpadów medycznych, co mający na uwadze oszczędne wydatkowanie pieniędzy Publicznych, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyrobu.

Pytanie nr14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2, pozycja 2,3, punkt a,b, c serwet wykonanych z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 61g/m² lub jeżeli Zamawiający oczekuje obłożenia o niższych parametrach oferujemy również obłożenie o gramaturze min. 54g/m².

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2, pozycja 2,3, punkt a, b, c serwet wykonanych z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 61g/m²

Pytanie nr15

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2, pozycja 1,2,3 Osłona wykonana w całości z czerwonej folii PE o gramaturze min. 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w strefie wzmocnionej. Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia min. 80g/m². Serweta składana teleskopowo z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwi wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Całkowity rozmiar serwety min. 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej min. 140 cm x 60 cm. Minimalna chłonność osłony w strefie krytycznej 350%.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyrobu.

Pytanie nr16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2, pozycja 3 kieszeni wykonanej z folii PE o grubości min. 0,06 mm

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyrobu.

Pytanie nr17

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie w pakiecie 2, pozycja 3 punkt f – czy nastąpiła omyłka pisarska i opis w postaci „(część lewa 15x30 oraz część prawa 25x30cm) dotyczy punktu g?.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zmienia zapis punktu g w pozycji 3 w Pakiecie nr 2 (Załącznik nr 4.2 do SIWZ), który otrzymuje brzmienie :

g) dwukomorowa kieszeń przylepna co najmniej 30x40cm(+/- 5%) na ssak i koagulację -1 szt, (część lewa 15x30cm oraz część prawa 25x30cm)-1szt

Pytanie nr18

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2, pozycja 4,5,6,7,10,11,12,13,14 serwet sterylnych o gramaturze 54 g/m², odporność na przenikanie cieczy min 250 cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro min 166/158 Kpa

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr19

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2, pozycja 5 serwety w rozmiarze 75x100 cm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyrobu.

Pytanie nr20

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2, pozycja 7 serwety w rozmiarze 150x200 cm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyrobu.

Pytanie nr21

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2, pozycja 10 serwety w rozmiarze 50x70 cm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyrobu.

Pytanie nr22

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2, pozycja 11 serwety w rozmiarze 75x100 cm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyrobu.

Pytanie nr23

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2, pozycja 13 serwety w rozmiarze 50x70 , otwór samoprzylepny w rozmiarze 6x8 cm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyrobu.

Pytanie nr24

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2, pozycja 13 serwety w rozmiarze 100x120 , otwór samoprzylepny o średnicy 10 cm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyrobu.

Pytanie nr25

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2, pozycja 15 serwety w rozmiarze 100x150 , otwór samoprzylepny o średnicy 10 cm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr26

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z pakietu 2, pozycji 16, 17, 18 ponieważ opisane przez Zamawiającego parametry przedmiotu zamówienia w całości spełnia

tylko jeden wykonawca. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia innemu wykonawcy złożenie konkurencyjnej oferty.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż dotychczasowa współpraca z Zamawiającym co do jakości oferowanych przez naszą firmę obłożeń nie budziła zastrzeżeń, uprzejmie prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Z analizy rynku przeprowadzonej przez Zamawiającego, wynika, że wymagane wyroby posiada kilku Wykonawców. Ponadto Zamawiający nie wydzielił poszczególnych pozycji z pakietów w niniejszym postępowaniu celem uniknięcia przedłużającej się procedury przetargowej i zabezpieczenia bloków operacyjnych w obłożeniu, co zapewni ciągłość wykonywanych zabiegów.

Pytanie nr27

Pakiet 14

Prosimy o wydzielenie z pakietu 14 poz. 2 i utworzenie z niej osobnego zadania.

Jesteśmy importerem podkładów podfoliowanych i chcielibyśmy złożyć konkurencyjną ofertę cenową.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr28

PAKIET NR 3

1. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie i parametrach:

1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu);

nieprzemakalność min. 150 cm H₂O; wytrzymałość na rozrywanie min. 75 kPa

1 x serweta 2-warstwowa pod pośladki 100 x 120 cm (+ 20 cm mankiet) z jedną kieszenią

1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL

włóknina SMMMS o gram. min. 40g/m², wzmocnienie o gram. min. 38g/m²

1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm; skład: 70% wiskoza; 30% poliestr, gram. ok. 50 g/m²

1 x Minigrip torebka strunowa 40 x 30 cm

2 x zacisk do pepowiny 53 mm biały

10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 6 warstw 30 g/m²

10 x tupfer z gazy 24 x 24 cm 20 nitek

1 x chusta gazowa z chipem RTG 45 x 45 cm, 4 warstwy 20 nitek, biała z tasiemką

Zestaw pakowany w opakowanie z min. dwoma samoprzylepnymi etykietami.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr29

PAKIET NR 4

1. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do embolizacji i angiografii spełniającego wymagania SIWZ, jednakże posiadającego w swoim składzie:

1 x serweta angiograficzna 187 x 300 cm z 2 otworami na tętnice udowe Ø 7 cm.

Ośłona na pulpit z prawej strony pacjenta. Serweta wykonana z laminatu 2-

warstwowego (PP+PE) o gram. min. 55 g/m² z dodatkowym padem chłonnym w strefie krytycznej o min. gram. 110 g/m²

1 x osłona na sprzęt medyczny 95 x 85 cm prostokątna PE (w miejsce 85 x 85 cm)

2 x osłona na sprzęt medyczny 102 x 102 cm prostokątna PE (w miejsce osłon 102 x 102cm i 100 x 80 cm)

1 x ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm

Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego zestawu

Pytanie nr30

PAKIET NR 6

1. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii spełniającego wymagania SIWZ, jednakże posiadającego w swoim składzie:

3 x opatrunek jałowy w rozmiarze 5 x 7,2 cm (w miejsce 4 x 5 cm)

2 x serweta samoprzylepna w rozmiarze 70 x 90 cm (w miejsce 75 x 95 cm)

1 x serweta samoprzylepna w rozmiarze 170 x 175 cm (w miejsce 175 x 175 cm)

1 x serweta samoprzylepna w rozmiarze 170 x 300 cm (w miejsce 175 x 300 cm)

1 x pokrowiec na kamerę w rozmiarze 15 x 244 cm lub 12,5 x 230 cm

Zestaw nie posiada w swoim składzie płynu przeciw parowaniu optyki.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ

Pytanie nr31

PAKIET NR 8

2. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do przysadki spełniającego wymagania SIWZ, jednakże posiadającego w swoim składzie (zgodnie z numeracją Zamawiającego)?

1. Serwetę do zabiegów neurochirurgicznych wykonana z laminatu 2- warstwowego (PP+PE) o min. gram. 55 g/m² z dodatkowym padem chłonnym w strefie krytycznej o min. gram. 110 g/m²; wytrzymałość na rozerwanie min. 196/186 kPa; wytrzymałość na penetrację płynów min. 197 cm H₂O, w strefie krytycznej min. 194 cm H₂O.

2. Serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 140 x 190 cm, obszar chłonny zgodny z SIWZ

3. Serweta na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm z warstwą chłonną min. 60 x 145 cm;

4. Serweta wykonana z laminatu 2- warstwowego (PP+PE)

5. Serweta wykonana z laminatu 2- warstwowego (PP+PE)

6. Serweta w rozmiarze 90 x 100 cm, laminat 2- warstwowy z dodatkowym padem chłonnym w strefie krytycznej

7. Serweta w rozmiarze 170 x 175 cm, laminat 2- warstwowy z dodatkowym padem chłonnym w strefie krytycznej

8. Ręczniki w rozmiarze min. 30 x 33 cm

9. 10 x Kompres neurochirurgiczny włókninowy z nitką RTG, rozmiar 15 x 15 cm

10. Podkładka time out w rozmiarze 21 x 14,8 cm lub mata z niebieskiej gąbki 50 x 40 cm

13. Torebka foliowa w rozmiarze 30 x 40 cm

14. Kieszon w rozmiarze 43 x 38 cm

Zestaw pakowany w opakowanie typu Ventbag
Pozostałe parametry i skład bez zmian.

3. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do przysadki bez wkładu foliowego do miski na odpady medyczne?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ- dotyczy części 1 i 2 zapytania.

Pytanie nr32

PAKIET NR 17

1. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego o następującym składzie:
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
1 x serweta 2- warstwowa przylepna 200 x 170 cm
1 x serweta 2- warstwowa przylepna 175 x 170 cm
2 x serweta 2- warstwowa przylepna 90 x 75 cm
1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm
1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm
1 x podstawka pod skalpele 3 miejsca
1 x taśma przylepna 10 x 50 cm
4 x ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego zestawu.

Pytanie nr33

PAKIET NR 3

1. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu porodowego posiadającego w swoim składzie serwetę pod pośladki (podkład pod położnicę) w rozmiarze 100 x 120 cm (+ 20 cm mankiet) z jedną kieszenią w rozmiarze 58 x 75 cm bez przylepnych pasków i brzegu umożliwiającego formowanie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ

Pytanie nr34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 14 poz.2 podkładu z perforacją co 37cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ

Pytanie nr35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 14 poz.2 podkładu w kolorze fioletowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 14 poz.2 podkładu w kolorze fioletowym

Pytanie nr36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 14 poz.2 podkładu w kolorze białym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 14 poz.2 podkładu w kolorze białym

Pytanie nr37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 14 poz.4 do osobnego zadania, co zwiększy konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie oferentów a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ? Obecny zapis wskazuje na konkretną firmę.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Z analizy rynku przeprowadzonej przez Zamawiającego, wynika, że wymagane wyroby posiada kilku Wykonawców. Ponadto Zamawiający nie wydziela poszczególnych pozycji z pakietów w niniejszym postępowaniu celem uniknięcia przedłużającej się procedury przetargowej i zabezpieczenia bloków operacyjnych w obłożeniu, co zapewni ciągłość wykonywanych zabiegów.

Pytanie nr38

Pakiet 6: Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

Zestaw serwet do laparoskopii /ułożenie proste/ o składzie:

serweta 150x190 cm (+/- 2%)- 1 szt,

fartuch chirurgiczny L –3 szt,

osłona na stolik Mayo 79x145 cm (+/- 2%)-1 szt,

miska z polipropylenu 500 ml-1 szt,

miska z polipropylenu 250 ml-1 szt,

kompres gazowy 10x10cm-30 szt,

ostrze nr 11 z osłonką i nasadką –1 szt,

opatrunek jałowy (5x7,2 cm)3 szt,

serweta operacyjna (75x90cm) z taśmą samoprzylepną-2 szt,

serweta operacyjna (180x180cm) cm z taśmą samoprzylepną- 1 szt,

serweta operacyjna (300x180 cm) z taśmą samoprzylepną-1 szt,

płyn przeciw parowaniu optyki –1 szt,

kieszon na narzędzia laparoskopowe-1 szt,

pokrowiec na kamerę zwykłą (15x250cm) -1 szt

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr39

Pakiet 10 poz.1: Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparaturę o wymiarach (33÷112)x56cm Śr. 68cm- opis Wymiarów (połowa obwodu gumki w stanie swobodnym÷połowa obwodu gumki w rozciągnięciu) x głębokość oraz średnica wyrobu gotowego na płasko. Folia o grubości $\geq 41 \mu\text{m}$?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr40

Pakiet 10 poz.2: Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparaturę o wymiarach (30÷72)x36cm Śr. 43cm- opis Wymiarów (połowa obwodu gumki w stanie swobodnym÷połowa obwodu gumki w rozciągnięciu) x głębokość oraz średnica wyrobu gotowego na płasko. Folia o grubości $\geq 41 \mu\text{m}$?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.


Pytanie nr41

Pakiet 10 poz.3: Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na ramię C o wymiarach 183x105cm. Folia o grubości $\geq 41 \mu\text{m}$?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr42

Pakiet 11 poz.1: Czy Zamawiający dopuści osłonę na mikroskop rozmiar 117x267, z boku 3 troki z przylepcami na końcu, 6 końcówek z rzepami do mocowania. Jak na załączonym obrazku:

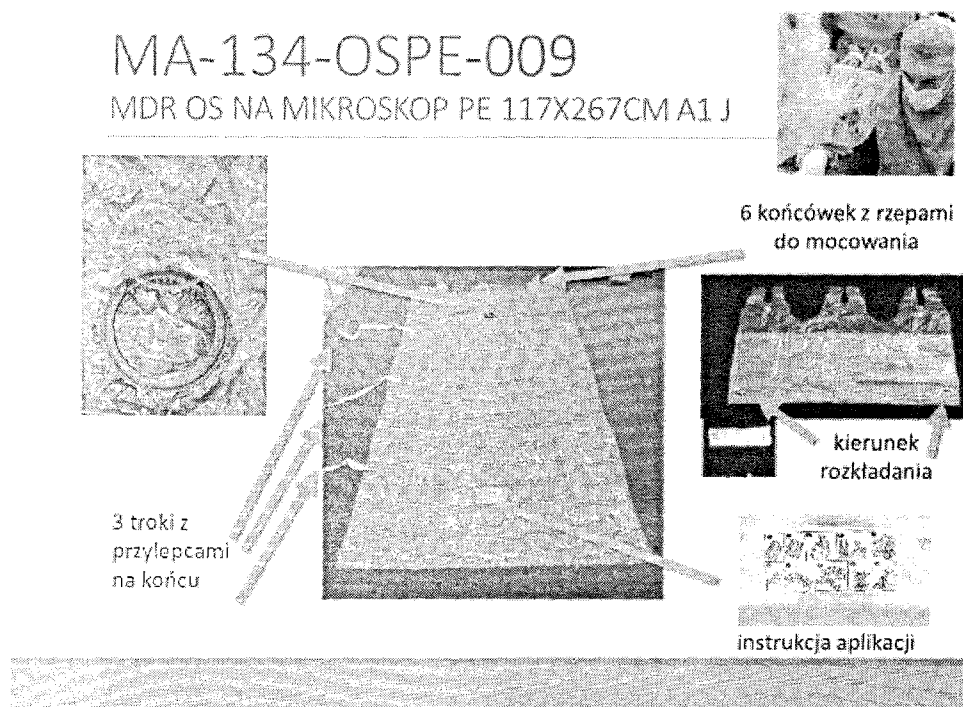

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr43

Pakiet 11: Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

Sterylna jednorazowa osłona na mikroskop o wymiarach (**117x267cm**),(+/- 1%)osłona obiektywu 65 mm. Wykonana z foli PE o grubości 41 mikrony, wyposażona w trzy 6 wprowadzenia na podglądy, które posiadają perforowane końcówki i uchwyty do mocowania w postaci rzepów. Osłona dodatkowo wyposażona w **3 taśmy**. Sposób złożenia osłony umożliwiający aseptyczną aplikację.

Opakowania jednostkowe z podwójną przylepną metką z datą ważności i numerem serii do dokumentacji medycznej. Opakowanie zbiorcze w postaci kartonu , które posiada czytelną etykietkę określającą wymiary osłony, numer Ref., ilość sztuk w podajniku i datę ważności.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr44

pakiet 15 poz.1-2: Czy Zamawiający wymaga aby hydrofobowe falbanki boczne zabezpieczające przed wyciekaniem skierowane były na zewnątrz?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie nr45

Pakiet 16: Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

- 1.Serweta operacyjna z otworem, trzywarstwowa, sterylna, wymiary nie mniej niż 140cm x 170cm, wykonana z materiału typu SMS o gramaturze 56g/m² na całej powierzchni, wymiary otworu 9(±1)cm x 12(±1)cm, otwór wypełniony folią chirurgiczną , warstwa klejowa na całej folii chirurgicznej, kolor zielony lub niebieski; z kieszenią przylepną do przechwytywania płynów, sterylną, wymiary nie mniej niż 30(±10)cm x 30(±10)cm, wykonaną z folii przezroczystej, wyposażoną w taśmę mocującą i sztywnik utrzymujący kształtowanie otworu – 1 sztuka
- 2.Serweta na solik w rozmiarze (**90x130cm**)zawinięcie zestawu – 1 sztuka
- 3.Ręcznik – 4 sztuk
- 4.Fartuch chirurgiczny rozmiar L – 2 sztuki
- 5.Serweta w rozmiarze (**90x130cm**) – 1 sztuka
- 6.Osłona na tackę fako (**50x60cm**) – 1 sztuka
- 7.Osłona na podłokietnik– 2 sztuki w rozmiarze (**35x60cm**)
- 8.Osłona na ekran 50 x 50cm – 1 sztuka
- 9.Kieliszek plastikowy **60 ml** – 1 sztuka
- 10.Metki do dokumentacji pacjenta, z nazwa zestawu – (**4 szt.**)
- 11.Mayo (**80x145 cm**) – 1 sztuka
- 12.Misceczka plastikowa zawierająca:
13. Strzykawka 2,5ml Luer Lock – 1 sztuka
- 14.Strzykawka 5ml Luer Lock – 2 sztuki
- 15.Kocher plastikowy
- 16.Gąbki mikrochirurgiczne, strzałki – 5 sztuk
- 17.Kompresy z włókniny 7,5 x 7,5cm – 10 sztuk
- 18.Opatrunek na oko samoprzylepne – 1 sztuka

Serwety wykonane z laminatu trójwarstwowego o gram 73 g/m² , nieprzemakalności powyżej 180cm H₂O lub dwuwarstwowa o gram 56g/m² , nieprzemakalności powyżej 250 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr46

Pakiet 16: Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

- 1.Serweta operacyjna z otworem, trzywarstwowa, sterylna, wymiary nie mniej niż 140cm x 170cm, wykonana z materiału typu SMS o gramaturze 56g/m² na całej powierzchni, wymiary otworu 9(±1)cm x 12(±1)cm, otwór wypełniony folią chirurgiczną , warstwa klejowa na całej folii chirurgicznej, kolor zielony lub niebieski; z kieszenią przylepną do przechwytywania płynów, sterylną, wymiary nie mniej niż 30(±10)cm x 30(±10)cm, wykonaną z folii przezroczystej, wyposażoną w taśmę mocującą i sztywnik utrzymujący kształtowanie otworu – 1 sztuka
- 2.Serweta na solik w rozmiarze (**90x130cm**)zawinięcie zestawu – 1 sztuka
- 3.Ręcznik – 4 sztuk
- 4.Fartuch chirurgiczny rozmiar L – 2 sztuki
- 5.Serweta w rozmiarze (**90x130cm**) – 1 sztuka
- 6.Osłona na tackę fako (**50x60cm**) – 1 sztuka

- 7.Osłona na podłokietnik– 2 sztuki w rozmiarze **80x45 cm**
- 8.Osłona na ekran 50 x 50cm – 1 sztuka
- 9.Kieliszek plastikowy **60 ml** – 1 sztuka
- 10.Metki do dokumentacji pacjenta, z nazwa zestawu – (**4 szt.**)
- 11.Mayo (**80x145 cm**) – 1 sztuka
- 12.Miseczka plastikowa zawierająca:
13. Strzykawka 2,5ml Luer Lock – 1 sztuka
- 14.Strzykawka 5ml Luer Lock – 2 sztuki
- 15.Kocher plastikowy
- 16.Gąbki mikrochirurgiczne, strzałki – 5 sztuk
- 17.Kompresy z włókniny 7,5 x 7,5cm – 10 sztuk
- 18.Opatrunek na oko samoprzylepne – 1 sztuka

Serwety wykonane z laminatu trójwarstwowego o gram 73 g/m2 , nieprzemakalności powyżej 180cm H2O lub dwuwarstwowa o gram 56g/m2 , nieprzemakalności powyżej 250 cm H2O?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr47

Pakiet 17: czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

- Serweta na stół narzędziowy wzmocniona (**190x150cm**) (opakowanie zestawu) – 1 sztuk
- Serweta na stolik Mayo 80 x 145cm składana teleskopowo z chłonnym padem na całej długości – 1 sztuka
- Serweta 2 - warstwowa przylepna (**180x170 cm**)– 1 sztuka
- Serweta 2 – warstwowa przylepna 90 x 75 cm – 3 sztuki
- Serweta 2 -warstwowa przylepna (**240x180 cm**)-1 sztuka
- Czyścik do koagulacji 5 x 5cm, kontrastujący w RTG – 1 sztuka
- Podstawka pod skalpele 3 miejsca – 1 sztuka
- Taśma przylepna (**9x50cm**)– 2 sztuki
- Ręcznik celulozowy o wym. (**20x40cm**)– 4 sztuki

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr48

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Zamawiający jako dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Pytanie nr49

Zważywszy na treść § 2 ust. 13 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można

zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa procentowej ilości wyrobów medycznych jakie zamówi z zawartej umowy przetargowej, tym samym nie zmienia zapisów §2 ust.13 wzoru umowy zgodnie z którymi „Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania ”. Powyższe wynika, ze specyfiki prowadzonej przez Zamawiającego działalności

Pytanie nr50

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza proponowanego zapisu do wzoru

Pytanie nr51

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. c) wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty wynagrodzenia brutto (za daną część zamówienia) określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie lub rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej określonej w § 5 ust. 1 lit. c) wzoru umowy

Pytanie nr52

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza proponowanego zapisu do wzoru

Pytanie nr53

Dotyczy pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 14; pozycja 4): podkład chłonny o dużej wydajności w rozmiarze 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności 2100g?

Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytuje: „...specjalnej technologii typu Super Core bakterie (w tym MRSA) zostają zatrzymane w podkładzie ...” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Z analizy rynku przeprowadzonej przez Zamawiającego, wynika, że wymagane wyroby posiada kilku Wykonawców. Ponadto Zamawiający nie wydzielił poszczególnych pozycji z pakietów w niniejszym postępowaniu celem uniknięcia przedłużającej się procedury przetargowej i zabezpieczenia bloków operacyjnych w obłożeniu, co zapewni ciągłość wykonywanych zabiegów.

Pytanie nr54

Dotyczy pakietu nr 15

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 15): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów pkt. VII.4 SIWZ dotyczących dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

Pytanie nr55

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 15): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyrobu.

Pytanie nr56

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 15): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyrobu.

Pytanie nr57

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 15): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barrierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce kroczu przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyrobu.

Pytanie nr58

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 15): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtkce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą - brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyrobu.

Pytanie nr59

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 15; pozycja 2): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr60

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 15; pozycja 1): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 73-122cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr61

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 15; pozycja 2): pieluchomajtki przeznaczone dla osób o średnim, ciężkim i bardzo ciężkim nietrzymaniu moczu, czyli o poziomie chłonności co najmniej 3050g?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyrobu.

Pytanie nr62

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 15; pozycja 1): pieluchomajtki przeznaczone dla osób o średnim, ciężkim i bardzo ciężkim nietrzymaniu moczu, czyli o poziomie chłonności co najmniej 2800g?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyrobu.

Pytanie nr63

Pakiet 1 Poz. 3-4

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 3 i 4 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr64

Pakiet 1 Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie zestawu do zabiegów ginekologicznych dolnych o następującym składzie i parametrach:

1 x serweta o wym. 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny oraz wyposażona w samoprzylepny otwór w okolicy krocza o wym. 10 cm x 15 cm zintegrowany ze zbiornikiem na płyny

Serweta wykonana z 2 warstwowego laminatu gramatura 56 g/m², zintegrowana ze zbiornikiem na płyny o wym. 50 cm x 50 cm. Zbiornik wykonany z folii PE, gramatura 65 g/m², wyposażony w filtr, sztywnik oraz port do podłączenia drenu.

1 x serweta o wym. 75 cm x 90 cm bez przylepca

Serweta wykonana z 2 warstwowego laminatu, gramatura 56g/m².

4 x ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Ręcznik wykonany z włókniny typu spunlance, gramatura 45g/m²

1 x taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm

Taśma samoprzylepna włókninowa, gramatura 68 g/m²

1 x serweta na stolik o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta bez przylepca wykonana z wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego zestawu

Pytanie nr65

Pakiet 1 Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie i parametrach:

1 x serweta o wym. 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, wyposażona w samoprzylepny otwór w okolicy krocza o wym. 10 cm x 15 cm zabezpieczony kłapką oraz samoprzylepny otwór brzuszny w kształcie trapezu o wym. 30 cm x 20 cm x 20 cm

Serweta wykonana z 2 warstwowego laminatu, gramatura 56g/m².

1 x serweta na stolik o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta bez przylepca wykonana z wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego zestawu

Pytanie nr66

Pakiet 2 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego, wzmocnionego o następującym składzie i parametrach :

1 x serweta o wym. 150 cm x 240 cm z taśmą samoprzylepną zintegrowana z uchwytami przewodów

Serweta wykonana z 3 warstwowego laminatu, gramatura 72g/m², wzmocniona w strefie krytycznej dodatkową warstwą chłonną 80 g/m² o wymiarach 25 cm x 60cm, łączna gramatura strefy krytycznej 152 g/m²

1 x serweta o wym. 180 cm x 180 cm z taśmą samoprzylepną zintegrowana z uchwytami przewodów

Serweta wykonana z 3 warstwowego laminatu, gramatura 72g/m², wzmocniona w strefie krytycznej dodatkową warstwą chłonną 80 g/m² o wymiarach 25 cm x 60cm, łączna gramatura strefy krytycznej 152 g/m²

2 x serweta o wym. 75 cm x 90 cm z taśmą samoprzylepną zintegrowana z uchwytami przewodów

Serweta wykonana z 3 warstwowego laminatu, gramatura 72g/m², wzmocniona w strefie krytycznej dodatkową warstwą chłonną 80 g/m² o wymiarach 25 cm x 60cm, łączna gramatura strefy krytycznej 152 g/m²

4 x ręcznik do rąk o wym. 30,5 cm x 34 cm

Ręcznik chłonny celulozowy, gramatura min. 60 g/m²

1 x taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm

Taśma samoprzylepna włókninowa, gramatura min. 68 g/m²

1 x osłona na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

Osłona wykonana z niebieskiej folii PE, gramatura 47g/m² oraz laminatu chłonnego, gramatura 57g/m², gramatura całkowita w obszarze wzmocnionym 104 g/m² Całkowity rozmiar strefy chłonnej 60 cm x 85 cm.

1 x serweta na stolik o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta bez przylepca wykonana z wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Opakowanie typu folia-papier wyposażone w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego zestawu

Pytanie nr67

Pakiet 2 Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego o następującym składzie i parametrach :

1 x serweta o wym. 150 cm x 230 cm z taśmą samoprzylepną w środkowej części szerszej krawędzi serwety

Serweta wzmocniona o konstrukcji strefowej wykona w całości z materiału nieprzemakalnego o gramaturze 40 g/m² oraz strefy wysokochłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i łącznej gramaturze 70 g/m²

1 x serweta o wym. 150 cm x 180 cm z taśmą samoprzylepną w środkowej części krótszej krawędzi serwety

Serweta wzmocniona o konstrukcji strefowej wykona w całości z materiału nieprzemakalnego o gramaturze 40 g/m² oraz strefy wysokochłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i łącznej gramaturze 70 g/m²

2 x serweta o wym. 75 cm x 90 cm z taśmą samoprzylepną na całej długości szerszej krawędzi serwety

Serweta wzmocniona o konstrukcji strefowej wykona w całości z materiału nieprzemakalnego o gramaturze 40 g/m² oraz strefy wysokochłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i łącznej gramaturze 70 g/m²

4 x ręcznik do rąk o wym. 30,5 cm x 34 cm

Ręcznik chłonny celulozowy, gramatura min. 60 g/m²

1 x taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm

Taśma samoprzylepna włókninowa, gramatura min. 68 g/m²

1 x osłona na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

Osłona wykonana z niebieskiej folii PE, gramatura 42 g/m² oraz włókniny chłonnej w strefie wzmocnionej. Gramatura całkowita w obszarze wzmocnionym 72 g/m² Całkowity rozmiar strefy chłonnej 60 cm x 145 cm.

1 x serweta na stolik o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta bez przylepca wykonana z wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Opakowanie typu folia-papier wyposażone w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego zestawu

Pytanie nr68

Pakiet 2 Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie serwety dolnej o wymiarach 150 cm x 180 cm wykończonej taśmą samoprzylepną w środkowej części krótszej krawędzi serwety.

Odpowiedź:

Pytanie nr69

Pakiet 2 Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego o następującym składzie :

1 x serweta o wym. 150 cm x 240 cm z taśmą samoprzylepną w środkowej części szerszej krawędzi serwety

1 x serweta o wym. 150 cm x 180 cm z taśmą samoprzylepną w środkowej części krótszej krawędzi serwety

2 x serweta o wym. 75 cm x 90 cm z taśmą samoprzylepną na całej długości szerszej krawędzi serwety

4 x ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm
1 x kieszeń dwukomorowa o wymiarach 30 cm x 40 cm (15 cm x 30 cm sekcja lewa, 25 cm x 30 cm sekcja prawa)
1 x osłona na stół Mayo 80 cm x 140 cm
1 x serwetka na stół o wym. 150 cm x 190 cm
Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego zestawu

Pytanie nr70

Pakiet 2 Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetkę w rozmiarze 45x45cm z otworem o średnicy 6cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyrobu.

Pytanie nr71

Pakiet 2 Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetkę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyrobu.

Pytanie nr72

Pakiet 2 Poz. 13

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetkę w rozmiarze 50x75cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyrobu

Pytanie nr73

Pakiet 2 Poz. 16

Czy Zamawiający dopuści chłonną matę podłogową w rozmiarze 75x36cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyrobu

Pytanie nr74

Pakiet 3 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw porodowy o składzie i parametrach:

1 x serwetka bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m ²
2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m ²
3 x serwetka chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m ²
1 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm
1 x fartuch foliowy przedni o wymiarach 80 cm x 130 cm
2 x zaciskacz do pępowiny
10 x tupfer gazowy 30 cm x 30 cm

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierzenia oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Z osobno dołączoną sterylnie zapakowaną w opakowanie j.w.

Serwetą porodową wzmocnioną o wymiarach 114cm x 150cm zintegrowaną z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cmx80cm wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu

Serweta wykonana z 2 warstwowego laminatu, gramatura 57g/m², wzmocniona dodatkową warstwą chłonną 80 g/m², łączna gramatura strefy wzmocnionej 137 g/m², zbiornik wykonany z folii PE wyposażony w sztywnik oraz port do podłączenia drenu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego zestawu

Pytanie nr75

Pakiet 7 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści *zestawy zabiegowe bez konieczności podania klasy wyrobu medycznego*, zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego zestawu jeżeli spełnia wymagania określone w Art. 30, pkt 1 i 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 876 z późn. zm.);

Pytanie nr76

Pakiet 10 Poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na aparaturę RTG typu "beret" z przezroczystej folii polietylenowej, o gramaturze 35 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyrobu

Pytanie nr77

Pakiet 10 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę 3 -częściową z folii polietylenowej na ramię C RTG o parametrach:

- * część górna o wym. 100 cm x 160 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

- * część dolna o wym. 80 cm x 150 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

- * 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ

Pytanie nr78

Pakiet 14 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny na rolce z perforacją co 38cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyrobu

Pytanie nr79

Pakiet 14 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny na rolce składający się z dwóch warstw bibuły i jednej warstwy folii o długości 40mb?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyrobu

Pytanie nr80

Pakiet 20 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o składzie i parametrach:

1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów, wyposażona w 1 sztywnik. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr81

Pakiet 20 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o składzie i parametrach:

1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 140 cm x 240 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów, wyposażona w 1 sztywnik. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr82

Pakiet 23 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny pakowany po 25szt, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę przy odpowiednim przeliczeniu wymaganych ilości.

Pytanie nr83

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z pakietu 2, pozycji 16, 17, 18 ponieważ opisane przez Zamawiającego parametry przedmiotu zamówienia w całości spełnia tylko jeden wykonawca. Wydzielenie tych pozycji z pakietu nr 2 umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty przez większą ilość wykonawców. Jeżeli Zamawiający nie dokona podziału prosimy o wyjaśnienie, stosownie do treści art. 96 ust.1, pkt.11 PZP z dnia 29.01.2004 z późniejszymi zmianami.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Z analizy rynku przeprowadzonej przez Zamawiającego, wynika, że wymagane wyroby posiada kilku Wykonawców. Ponadto Zamawiający nie wydzielił poszczególnych pozycji z pakietów w niniejszym postępowaniu celem uniknięcia przedłużającej się procedury przetargowej i zabezpieczenia bloków operacyjnych w obłożeniu, co zapewni ciągłość wykonywanych zabiegów. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 23 części w zależności od rodzaju wymaganych wyrobów, uwzględniając przy tym specyfikę rynku oferującego obłożenia będące przedmiotem postępowania przetargowego.

Pytanie nr84

Pakiet nr 2, poz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 2 oraz utworzenie nowego pakietu. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr85

Pakiet nr 2, poz. 16

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie oraz dopuszczenie w w/w pozycji maty na podłogę do wykorzystania podczas zabiegów o chłonności 1,5 l w rozmiarze 81 cm x 122 cm z możliwością przytwierdzenia maty do podłoża. Produkt pakowany w opakowanie 25 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr86

Pakiet nr 2, poz. 17

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie oraz dopuszczenie w w/w pozycji jednorazowego, wysokochłonnego, nie uczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny wykonanego z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Podkład zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanianość co najmniej 4l potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta w co najmniej 5 miejscach. Oznaczenie ma zminimalizować

ryzyko pomyłki i być czytelne - minimum 100cm² każde. Gramatura produktu 125g/m² (+/- 1%). Produkt w opakowaniu po 50 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr87

Pakiet nr 2, poz. 18

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie oraz dopuszczenie w w/w pozycji jednorazowego, wysokochłonnego, nie uczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny wykonanego z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Podkład zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednolitej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanianie co najmniej 4l potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta w co najmniej 5 miejscach. Oznaczenie ma zminimalizować ryzyko pomyłki i być czytelne - minimum 100cm² każde. Gramatura produktu 125g/m² (+/- 1%). W zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu minimum 250kg i osłonami na podramienniki i podgłówek. Zestaw umożliwia kompleksowe zabezpieczenie stołu operacyjnego. Produkt w opakowaniu po 20 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego wyrobu. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 18 do osobnego Pakietu.

Pytanie nr88

Pakiet nr 11, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji jednorazowej bezlateksowej sterylnej wysokiej jakości osłony na mikroskop w rozmiarze 117 cm x 267 cm do zastosowania w mikroskopie z 3 okularami. Pokrowiec z płaską osłoną obiektywu o średnicy 65 mm o dużej przezierności, odporną na zarysowania, z materiału nie odbijającego światła i nie tłukącego. Soczewka łatwa do usunięcia w razie konieczności. Osłona wykonana z grubej, mocnej folii PE odpornej na rozerwania. Produkt posiadający 3 pasy ściągające – umożliwiające mocowanie na mikroskopie. Pakowana w sposób zgodny z normami i wygodny dla użytkownika w opakowanie typu folia papier. Produkty pakowane w karton wewnętrzny w formie podajnika po 10 sztuk oraz karton zewnętrzny, które posiadają czytelną etykietę, określającą wymiary osłony, numer ref, ilość sztuk w kartoniku, datę ważności.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr89

Pakiet nr 14, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji podkładu chłonnego w rozmiarze 60 cm x 90 cm o chłonności 1500 ml. Produkt posiadający superabsorbent we wkładzie chłonnym, który wykazuje właściwości bakteriobójcze i antyseptyczne, czynniki te chronią skórę przed odparzeniami i odleżynami. Delikatna warstwa wierzchnia – zastosowany specjalny materiał dodatkowo potęguje uczucie suchości i zdecydowanie wpływa na komfort

użytkownika. Zewnętrzna warstwa z nieprzepuszczalnej, antypoślizgowej folii zabezpiecza przed przeciekaniem i zapewnia utrzymanie podkładu we właściwym miejscu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr90

Pakiet nr 23, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu pakowanego po 30 sztuk. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę przy odpowiednim przeliczeniu wymaganych ilości.

Pytanie nr91

Zapytanie I – dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wymaga aby w poz. 1 zaoferowano zestaw serwet do laparoskopii, wykonany z trzywarstwowego laminatu (folia PE 40 mikronów, warstwa chłonna - włóknina 23 g/m2, warstwa komfortowa dla pacjenta 20 g/m2) wyposażony w dodatkową – czwartą warstwę chłonną z włókniny o gram. 50g/m2, odporność na przenikanie cieczy serwet 900 (+/- 1%) cmH2O, wytrzymałość na wypychanie 170 (+/- 1%) kPa w strefie krytycznej na mokro, oraz 290 (+/- 1%) kPa w strefie krytycznej na sucho, wyposażone w elastyczną taśmę samoprzylepną typu FLEX zapewniającą zwiększoną ochronę podczas zabiegów operacyjnych. Czy Zamawiający wymaga również, aby zestaw zapakowany był sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią oraz zaopatrzony w 4 odlepne metki identyfikujące wyrób i etykietę ze szczegółowym składem zestawu. Natomiast w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości, podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines? Dodatkowo czy Zamawiający wymaga, aby zestaw zawinięty był w serwetę na stolik instrumentariuszki, umożliwiając sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego zestawu.

Pytanie nr92

Zapytanie II – dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 1 zaoferowano sterylny pokrowiec na przewody w rozmiarze 17x200cm, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr93

Zapytanie II – dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 2 zaoferowano sterylną osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 80x145cm, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr94

Zapytanie II – dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 3 zaoferowano sterylną torbę do przechwytywania płynów w rozmiarze 50x50cm, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr95

Zapytanie II – dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 4 zaofierowano sterylną kieszeń dwukomorową w rozmiarze 2x15x30cm, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr96

Zapytanie II – dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 5 zaofierowano sterylną osłonę w kształcie kuli o średnicy 80cm, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr97

Zapytanie III – dotyczy Pakietu nr 20

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 1 zaofierowano serwetę operacyjną z otworem 9x12 cm w rozmiarze 130x150 cm wraz z kieszenią przylepną do przechwytywania płynów w rozmiarze 20x20 cm, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr98

(pakiet nr 20) Czy Zamawiający wymaga serwety podfoliowanej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr99

(pakiet nr 20) Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 4 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia kryteriów oceny ofert dotyczących terminu dostawy.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Badań i Rozwoju
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr A. Wójcik, kierownik
Kierownik Działu Zamówień Publicznych